


样品信息

样品名称:	SSC-PLX	采集者:	System
样品类型:	未知	样品组名称:	20180618
瓶号:	63	采集方法组:	20190323A
进样次数:	1	处理方法:	20190127
进样体积:	5.00 u1	通道名称:	2998 Ch1 220nm@1.2nm
运行时间:	20.0 Minutes	处理通道注释:	2998 Ch1 220nm@1.2nm
采集时间:	2019/5/28 10:25:17 CEST		
处理时间:	2019/5/28 10:47:21 CEST		

自动标尺色谱图

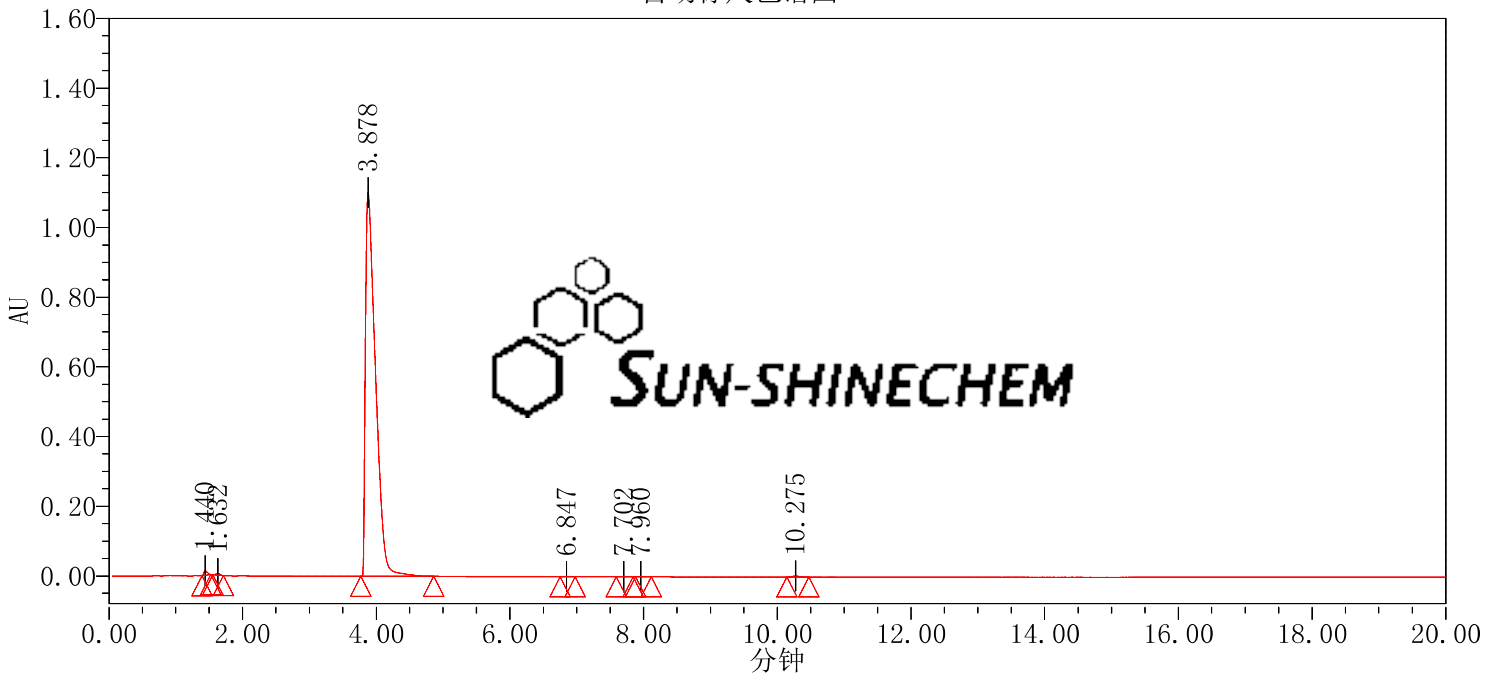

峰结果

名称	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	% 面积	纯度1 标记	纯度1 角度	纯度1 阈值
1	1.440	48837	13207	0.42			
2	1.632	21160	4762	0.18			
3	3.878	11563219	1101067	99.11			
4	6.847	4527	771	0.04			
5	7.702	3302	479	0.03			
6	7.960	2519	440	0.02			
7	10.275	23227	3040	0.20			