


样品信息

样品名称:	950455-15-9	采集者:	System
样品类型:	未知	样品组名称:	20180424
瓶号:	5	采集方法组:	20190513
进样次数:	1	处理方法:	20190127
进样体积:	5.00 u1	通道名称:	2998 Ch1 220nm@1.2nm
运行时间:	20.0 Minutes	处理通道注释:	2998 Ch1 220nm@1.2nm
采集时间:	2019/5/13 8:06:03 CEST		
处理时间:	2019/5/13 8:44:04 CEST		

自动标尺色谱图

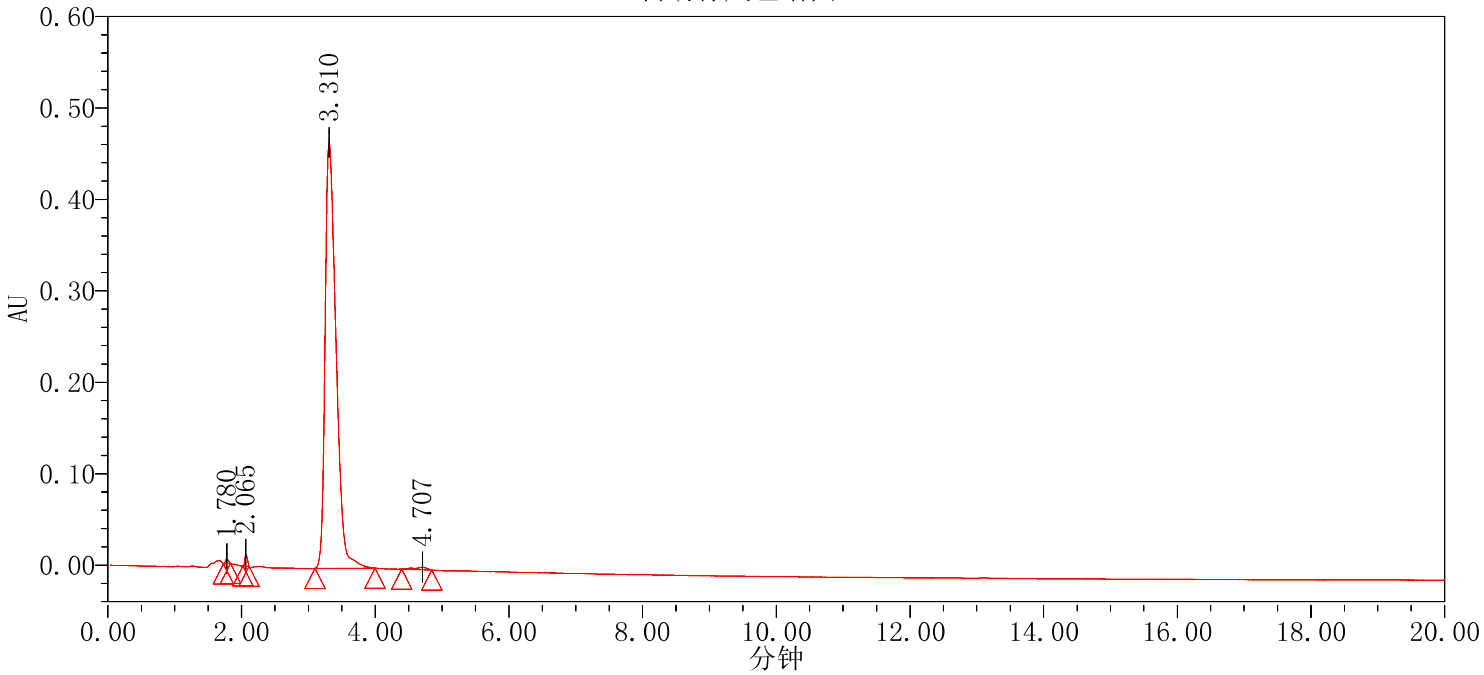

峰结果

名称	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	% 面积	纯度1 标记	纯度1 角度	纯度1 阈值
1	1.780	16422	5337	0.31			
2	2.065	33647	12940	0.63			
3	3.310	5278444	465636	98.40			
4	4.707	35627	2679	0.66			