


样品信息

样品名称:	SRT1720	采集者:	System
样品类型:	未知	样品组名称:	20180618
瓶号:	64	采集方法组:	20190323A
进样次数:	1	处理方法:	20190127
进样体积:	5.00 uL	通道名称:	2998 Ch1 220nm@1.2nm
运行时间:	20.0 Minutes	处理通道注释:	2998 Ch1 220nm@1.2nm
采集时间:	2019/5/28 10:54:14 CEST		
处理时间:	2019/5/28 11:30:28 CEST		

自动标尺色谱图

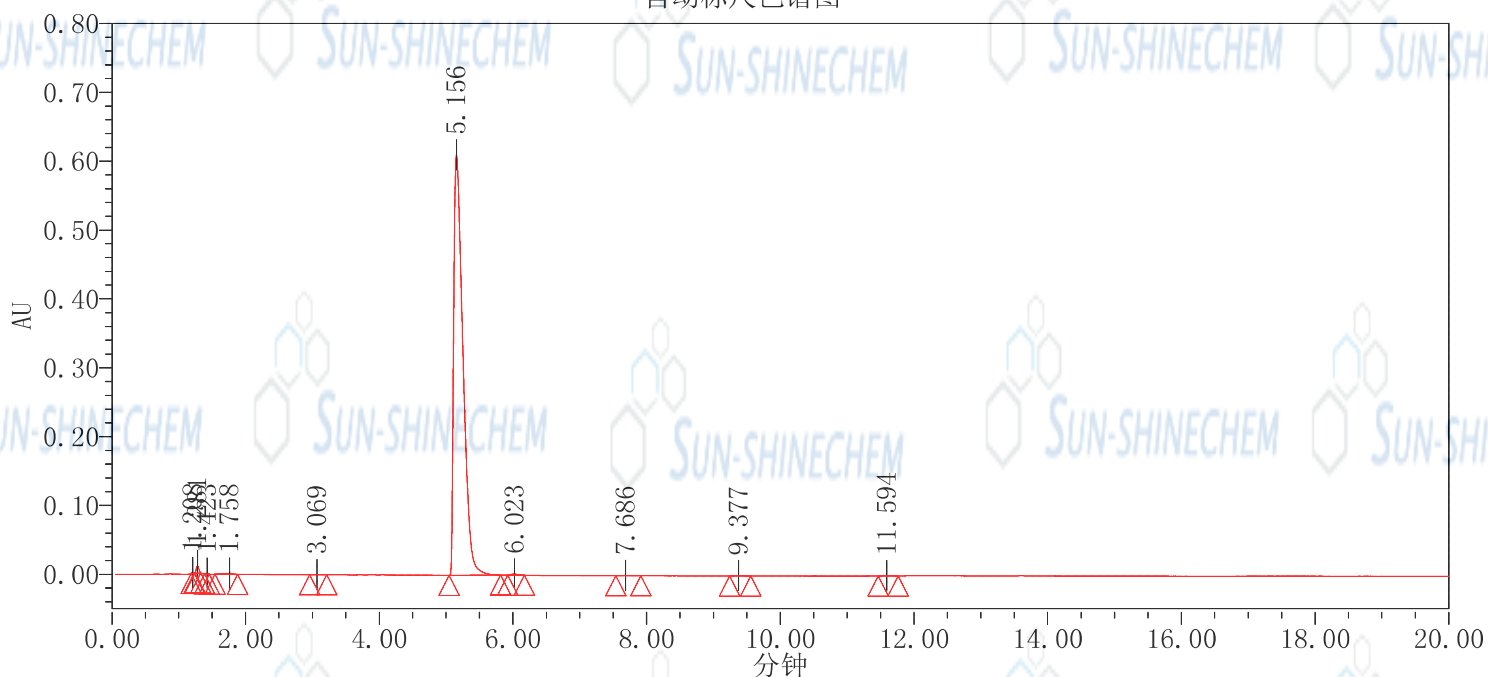

峰结果

名称	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	% 面积	纯度1 标记	纯度1 角度	纯度1 阈值
1	1.208	2255	1328	0.04			
2	1.281	26959	10331	0.45			
3	1.423	2937	1232	0.05			
4	1.758	16012	1546	0.27			
5	3.069	2209	318	0.04			
6	5.156	5873035	610775	98.76			
7	6.023	11980	1856	0.20			
8	7.686	3894	519	0.07			
9	9.377	4045	543	0.07			
10	11.594	3727	457	0.06			