


用户名称: System

项目名称: Defaults

样品信息

样品名称:	DCC2036	采集者:	System
样品类型:	未知	采集时间:	2019-6-27 14:36:10 CST
瓶号:	1:A,7	采集方法组:	新建等度70_30
进样次数:	1	处理日期:	2019-6-27 14:48:17 CST
进样体积:	2.00 ul	处理方法:	DCC2036
运行时间:	10.0 Minutes	通道名称:	W2996 254.0nm-1.2
样品组名称:	DCC2036	处理通道注释:	W2996 PDA 254.0 纳米 (于 1.2)

自动标尺色谱图

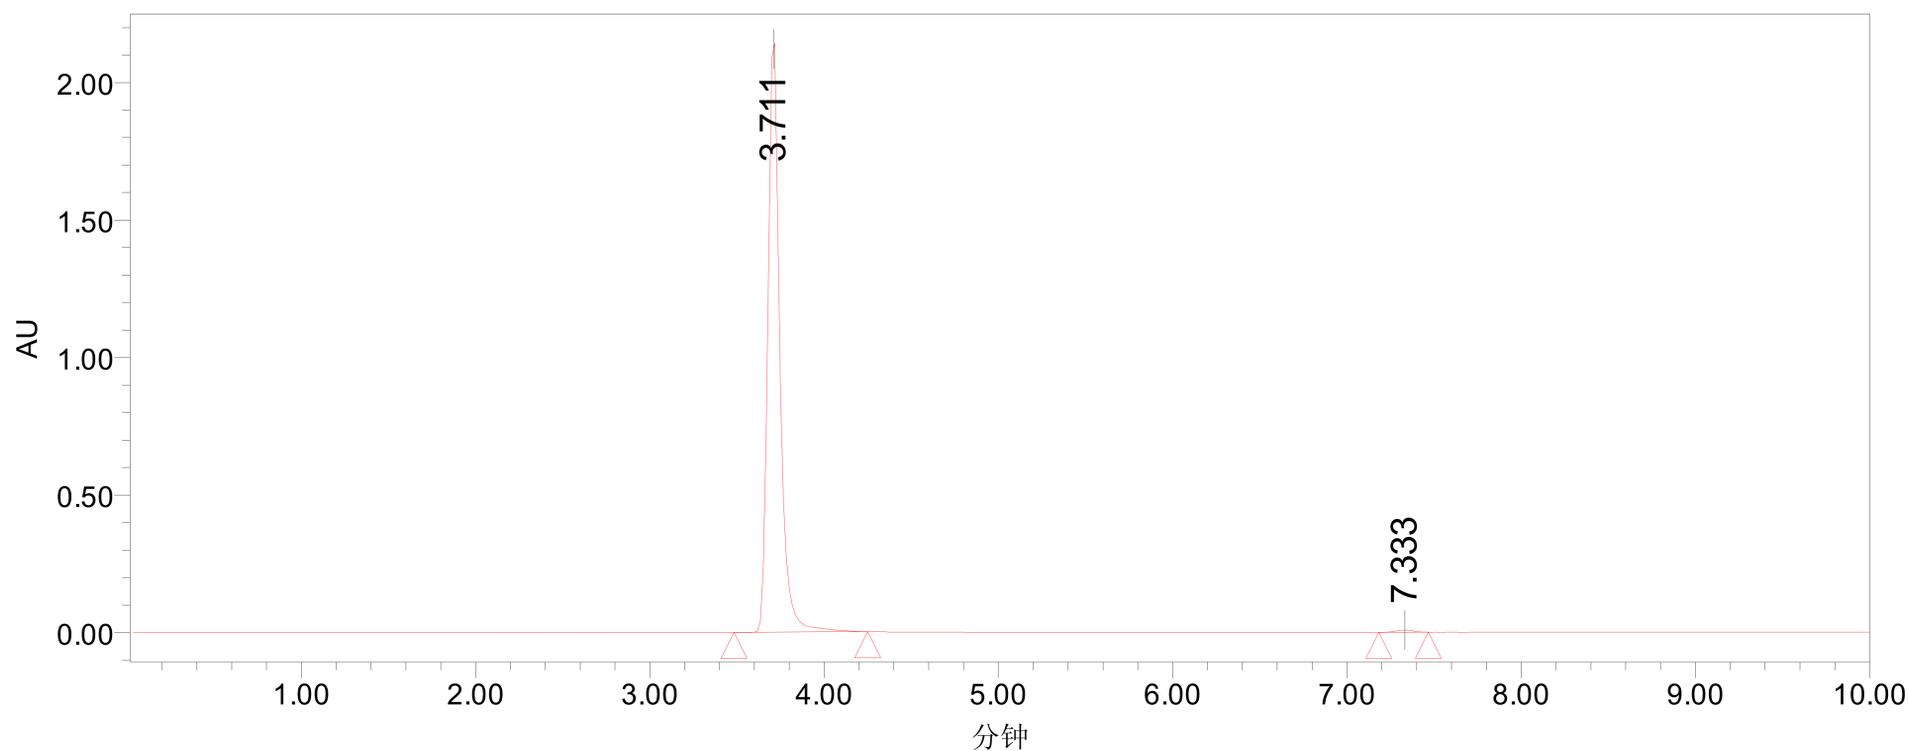

SampleName DCC2036; Vial 1:A,7; Injection 1; Channel W2996 254.0nm-1.2; Date Acquired 2019-6-27 14:36:10 CST

处理通道: W2996 PDA 254.0 纳米 (于 1.2)

	处理通道	保留时间 (分钟)	面积	% 面积	峰高
1	W2996 PDA 254.0 纳米 (于 1.2)	3.711	10294078	99.50	2101144
2	W2996 PDA 254.0 纳米 (于 1.2)	7.333	51730	0.50	7996